A Closer Look

Boston Scientific

RESUMEN

Este artículo resume los pasos para realizar una conexión correcta de marcapasos y desfibriladores de Boston a los que se hace referencia.

Para obtener instrucciones de cables completas, consulte el Manual técnico del médico del producto pertinente.

Productos a los que se hace Referencia

ADVANTIO™, INGENIO™, VITALIO™, FORMIO™, la familia de marcapasos ALTRUA™, INVIVE™, INTUA™, INLIVEN™ CRT-Ps, INCEPTA™, PUNCTUA™, ENERGEN™ TELIGEN™, COGNIS™, CONFIENT™, LIVIAN™ ICDs and CRT-Ds

Los productos a los que se hace referencia son marcas comerciales registradas o no registradas de Boston Scientific Corporation o sus filiales. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Los productos a los que se hace referencia pueden no estar aprobados en todos los países. Para obtener información exhaustiva sobre el funcionamiento del dispositivo, consulte las instrucciones de uso completas en: www.bostonscientific.com/cardiac-rhythm-resources/international-manuals.html.

PRECAUCIÓN: Las leyes solo permiten la venta de este dispositivo bajo prescripción facultativa. En el etiquetado del producto encontrará indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias.

Todos los gráficos han sido producidos por Boston Scientific Corporation, a menos que se especifique lo contrario.

TRC-D: Desfibrilador con tratamiento de resincronización cardiaca)
TRC-P: Marcapasos con tratamiento de resincronización cardiaca)
DAI: Desfibrilador automático implantable)
S-DAI: Desfibrilador implantable subcutáneo

Información de Contacto

Américas
(Caribbean, y Central, América del Norte y del Sur)
www.bostonscientific.com
Servicios Técnicos
Servidor Seguro LATITUDE
1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000
Servicios a Pacientes
1.866.484.3268

Europa, Medio Oriente, África
Servicios Técnicos
+32 2 416 7222
eurtechservice@bsci.com
Soporte Clinico para LATITUDE
latitude.europe@bsci.com

Asia y el Pacífico
Servicios Técnicos
+61 2 8063 8299
aptechservice@bsci.com
japantechservice@bsci.com
Servidor Seguro LATITUDE
latitude.asiapacific@bsci.com
japan.latitude@bsci.com (Japón)

© 2013 by Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Conexión de cables a marcapasos y desfibriladores de Boston Scientific

Pasos para la correcta conexión

Mirar a través de los puertos para verificar visualmente que los tornillos estén lo suficientemente retraídos para permitir la inserción de los cables.

Insertar suavemente el destornillador en la depresión central pre-abierta del tapón de sellado. Esto abrirá el tapón y proporcionará una vía de escape del fluido o del líquido atrapado en el puerto en cuanto se inserte el cable en el mismo.

Insertar el cable y verificar que el extremo terminal del mismo es claramente visible a través del bloque conector.

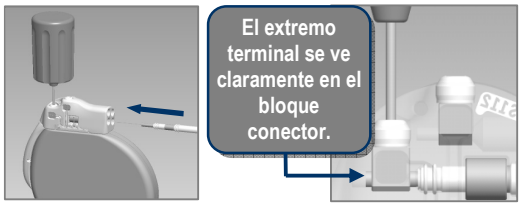

Asegurarse de que el destornillador entra perpendicular (90º) al bloque conector. Mientras se presiona el cable, atornillar ***lentamente*** en sentido horario hasta que suene el tope una vez (hace clic), manteniendo el destornillador perpendicular al bloque conector mientras se atornilla.

NOTA: *Es innecesario seguir apretando hacia abajo el destornillador mientras se atornilla.*

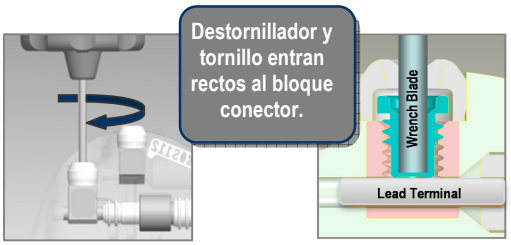

Retirar el destornillador del bloque conector tirando hacia arriba del propio destornillador.

Verificar la conexión del cable tirando suavemente de cada terminal. No tirar de la horquilla o de más de un terminal a la vez. Si un terminal no está fijo, reinsertar el destornillador, liberar el tornillo rotando en sentido anti-horario y repetir la secuencia anterior.